


Средств автоматизации и систем  
управления СССР

ПОВЕРОЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
Анемометр ручной чашечный тип «А» №  
Поверен на соответствие ГОСТ 6376-52  
и признан годным для эксплуатации  
ГРАФИК  
перевода показаний счетчика в показания скорости  
движения воздуха

4884

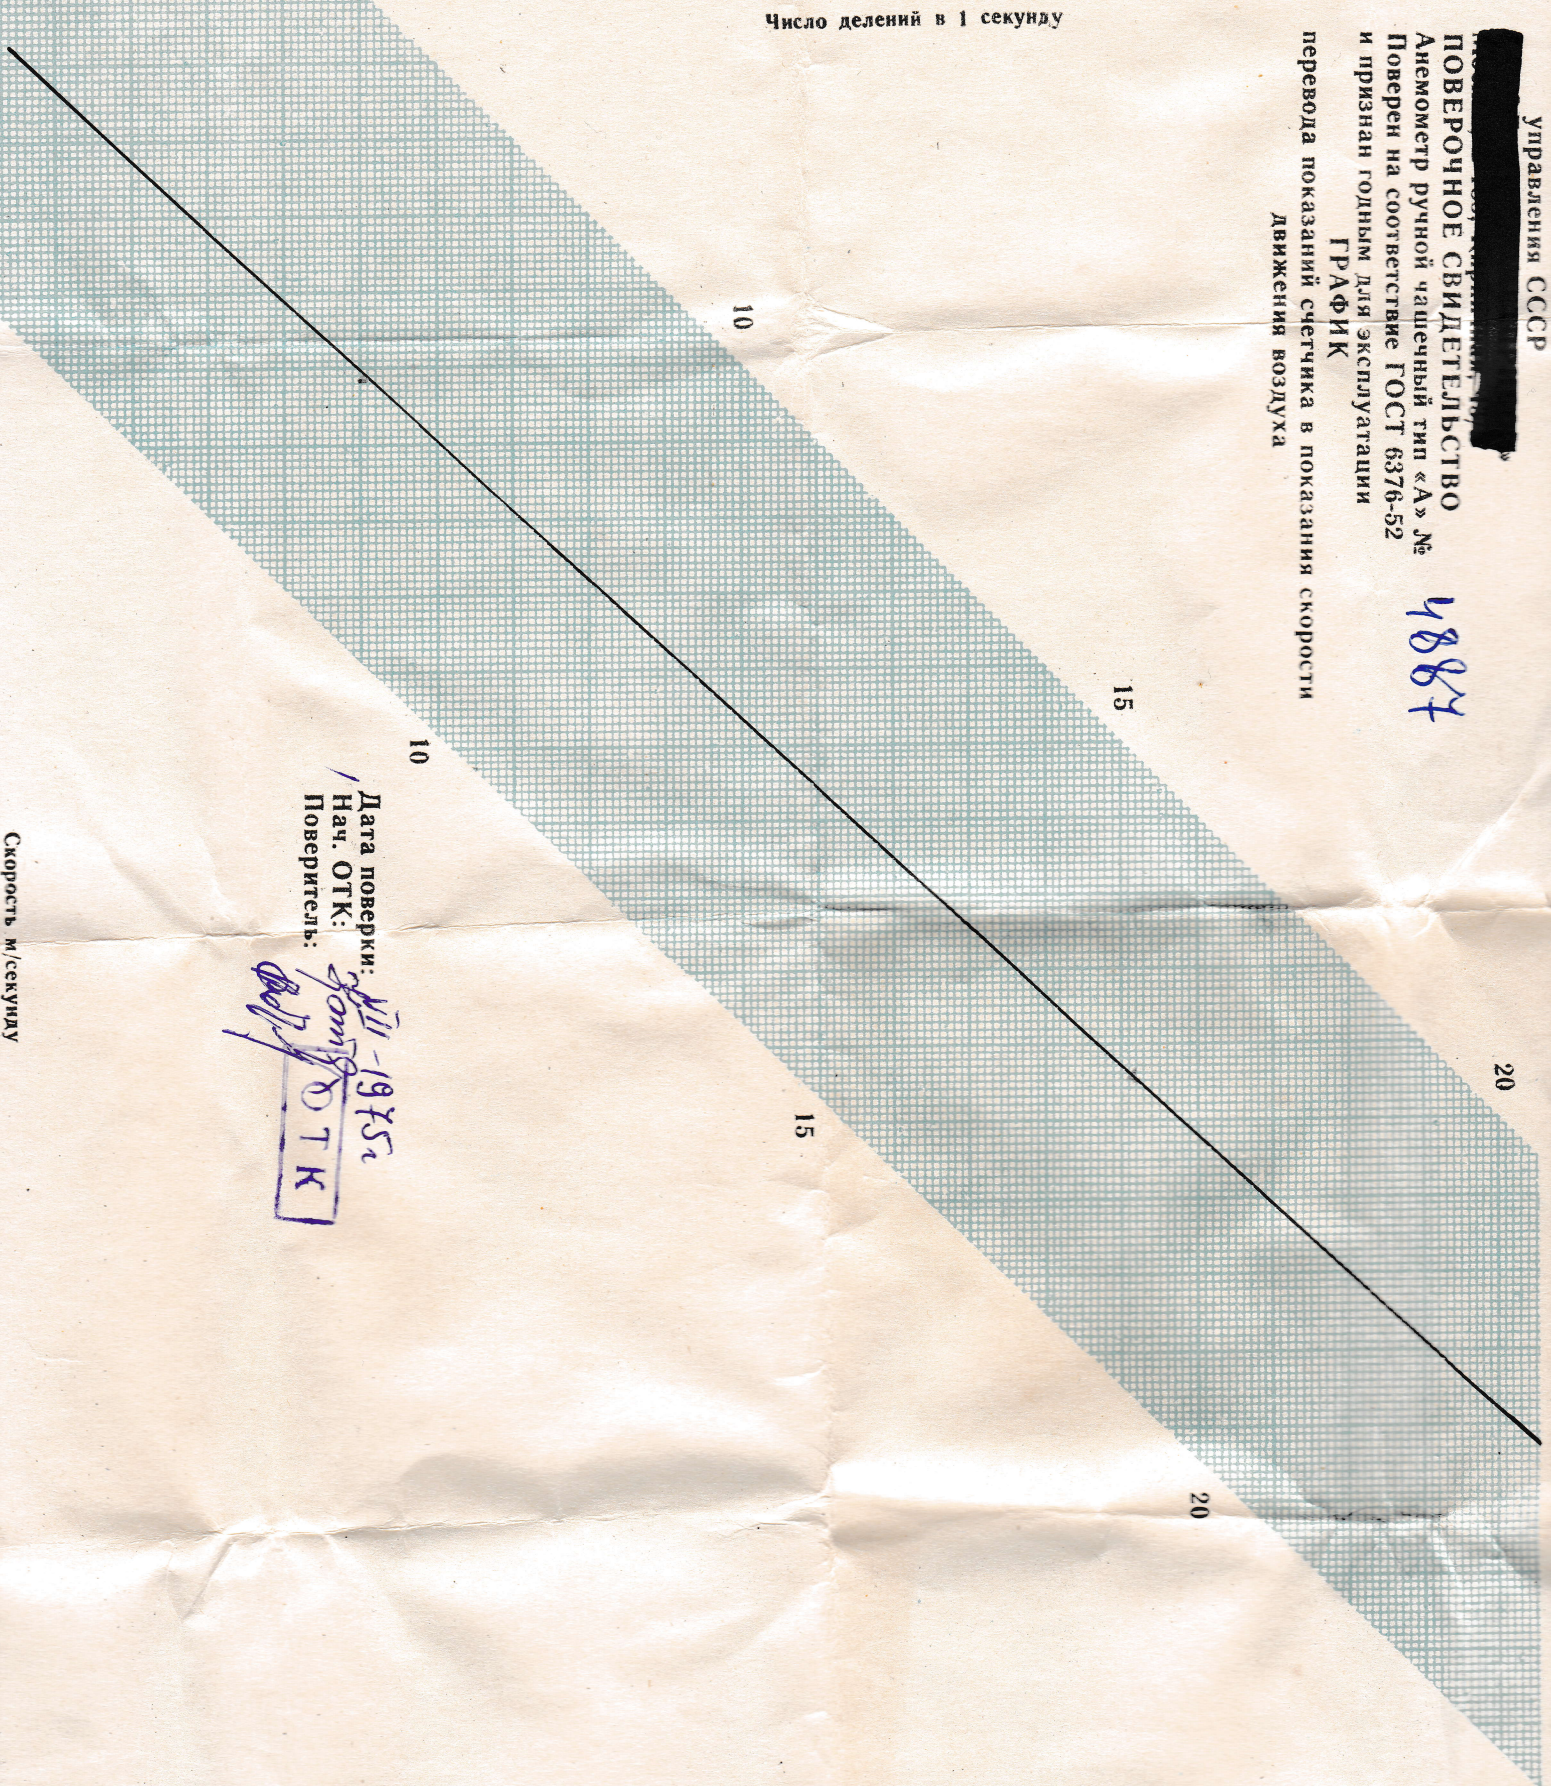

Дата поверки: VII-1975г  
Нач. ОТК: [Signature]  
Поверитель: [Signature]

ОТК

Скорость м/секунду